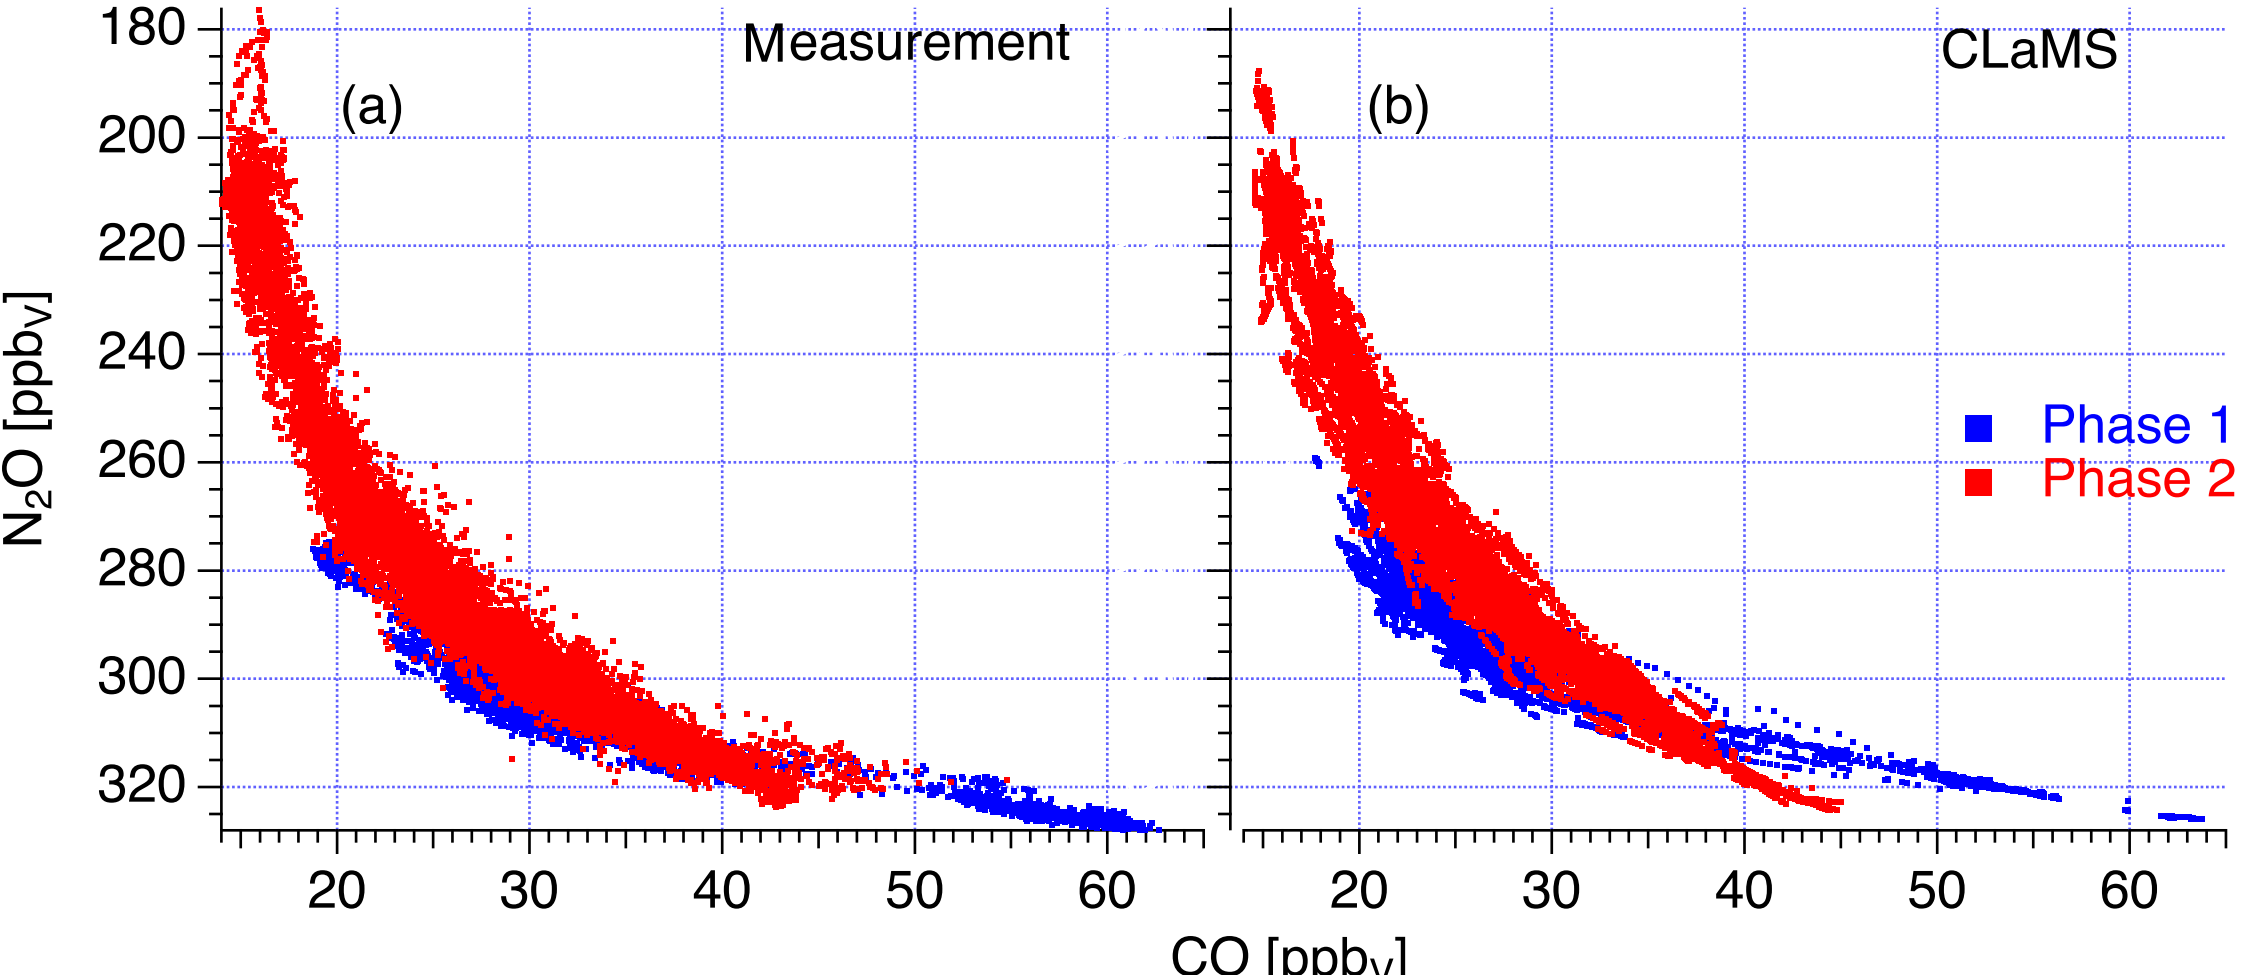
Measurement
(a)
CLaMS
(b)
Phase 1
Phase 2
N2O [ppbV]
CO [ppbV]
180
200
220
240
260
280
300
320
20
30
40
50
60