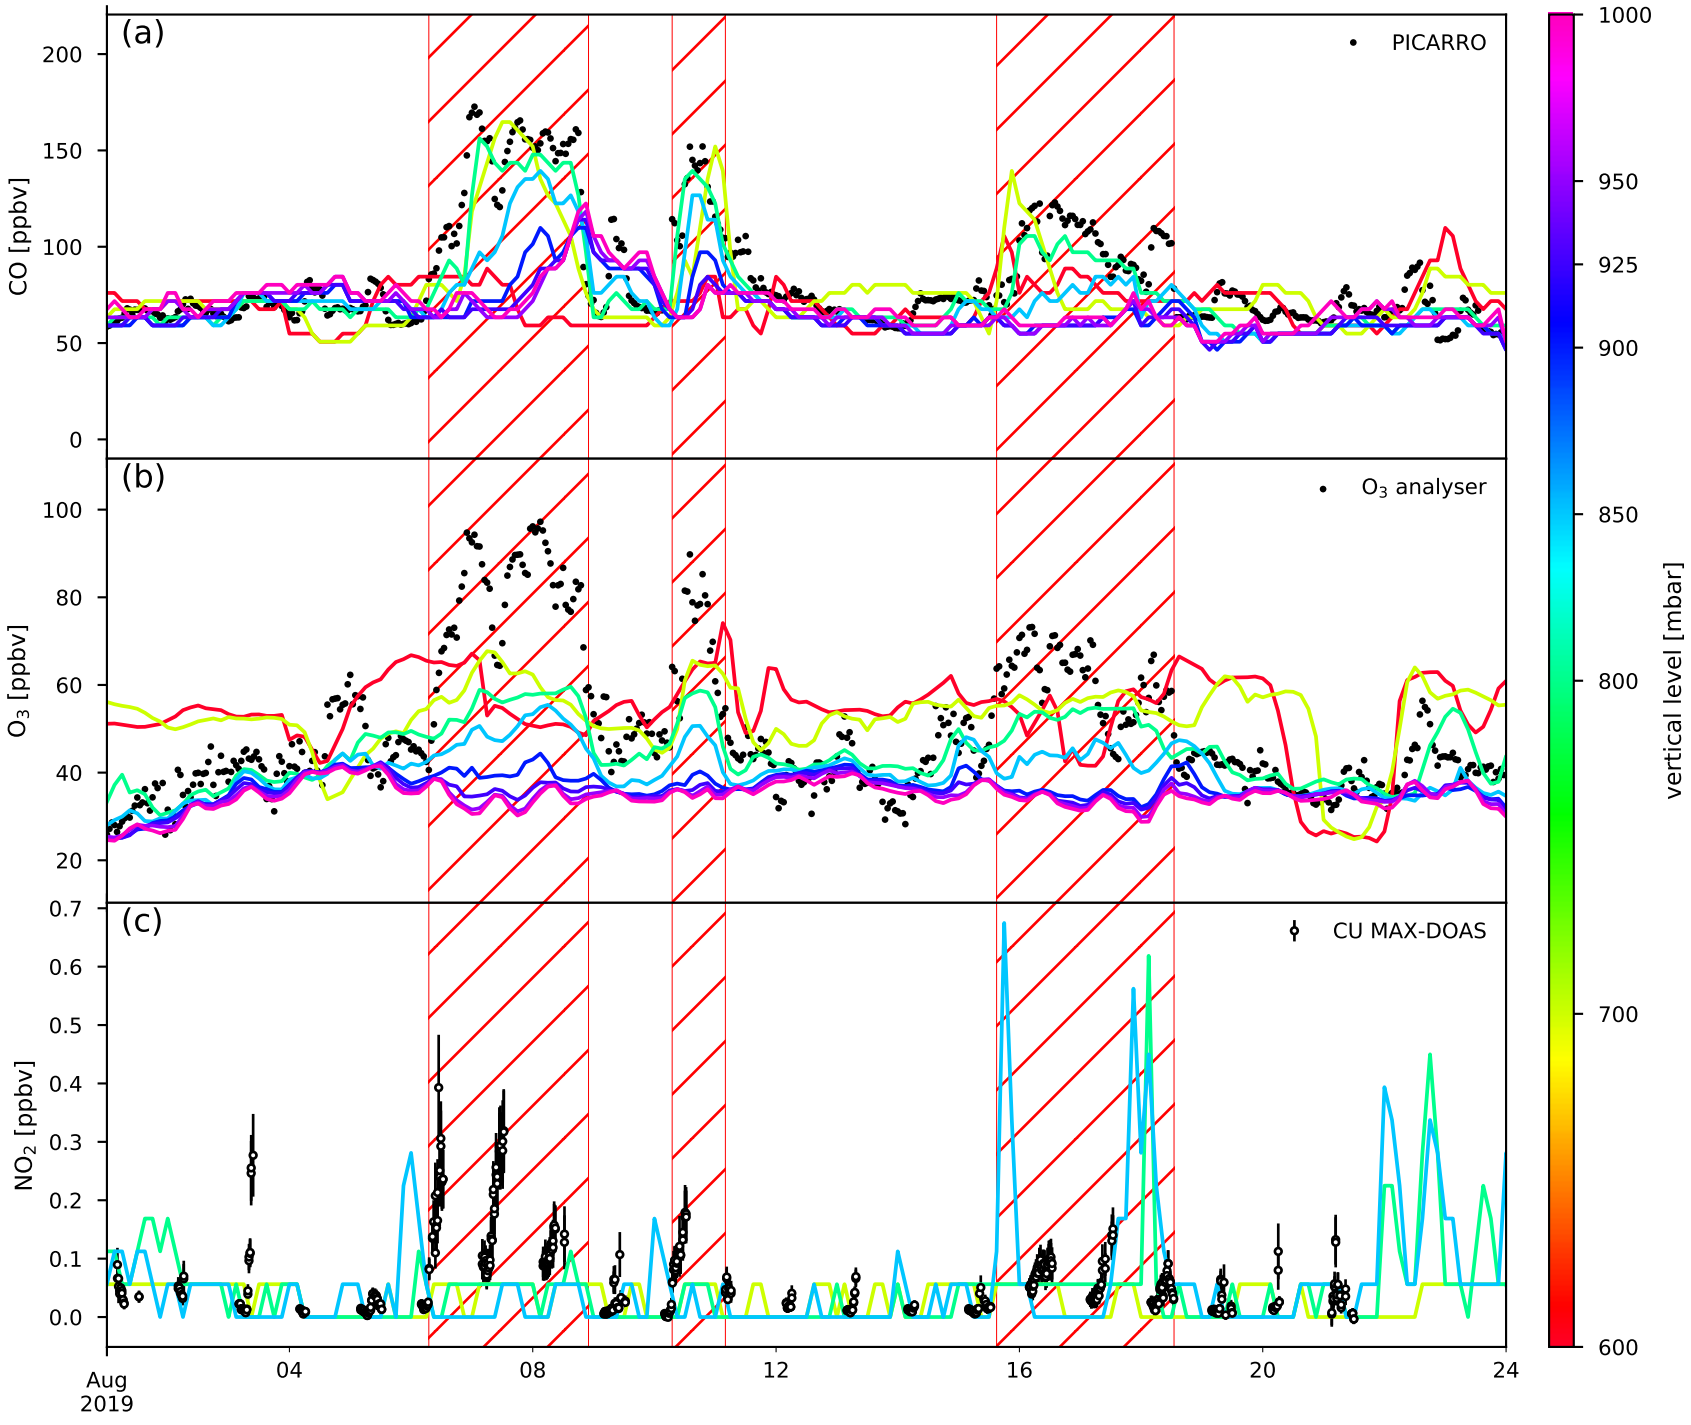
(a)
PICARRO
CO [ppbv]
0
50
100
150
200
(b)
O3 analyser
O3 [ppbv]
20
40
60
80
100
(c)
CU MAX-DOAS
NO2 [ppbv]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Aug
2019
04
08
12
16
20
24
vertical level [mbar]
600
700
800
850
900
925
950
1000